





**PHILIPS**  
RESPIRONICS  
InnoSpire Elegance



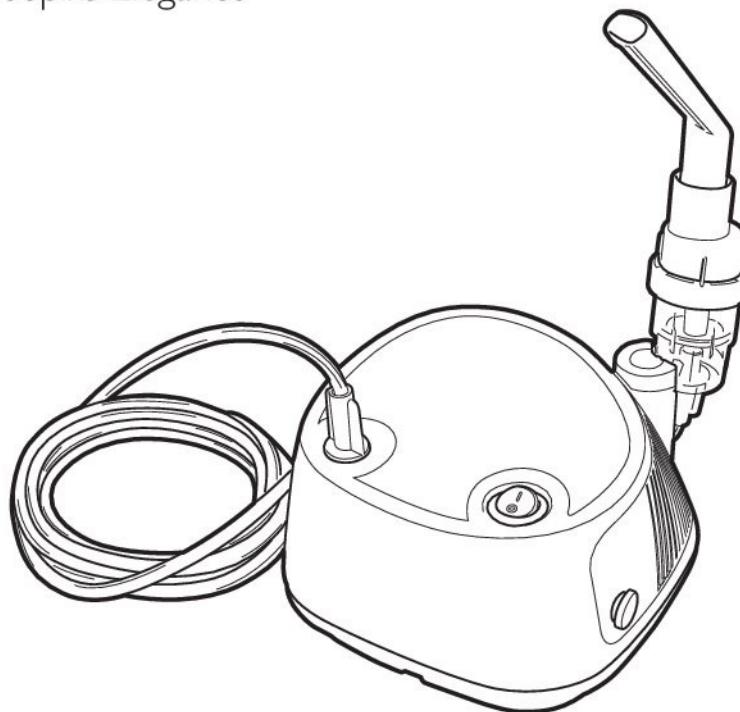

## InnoSpire Elegance

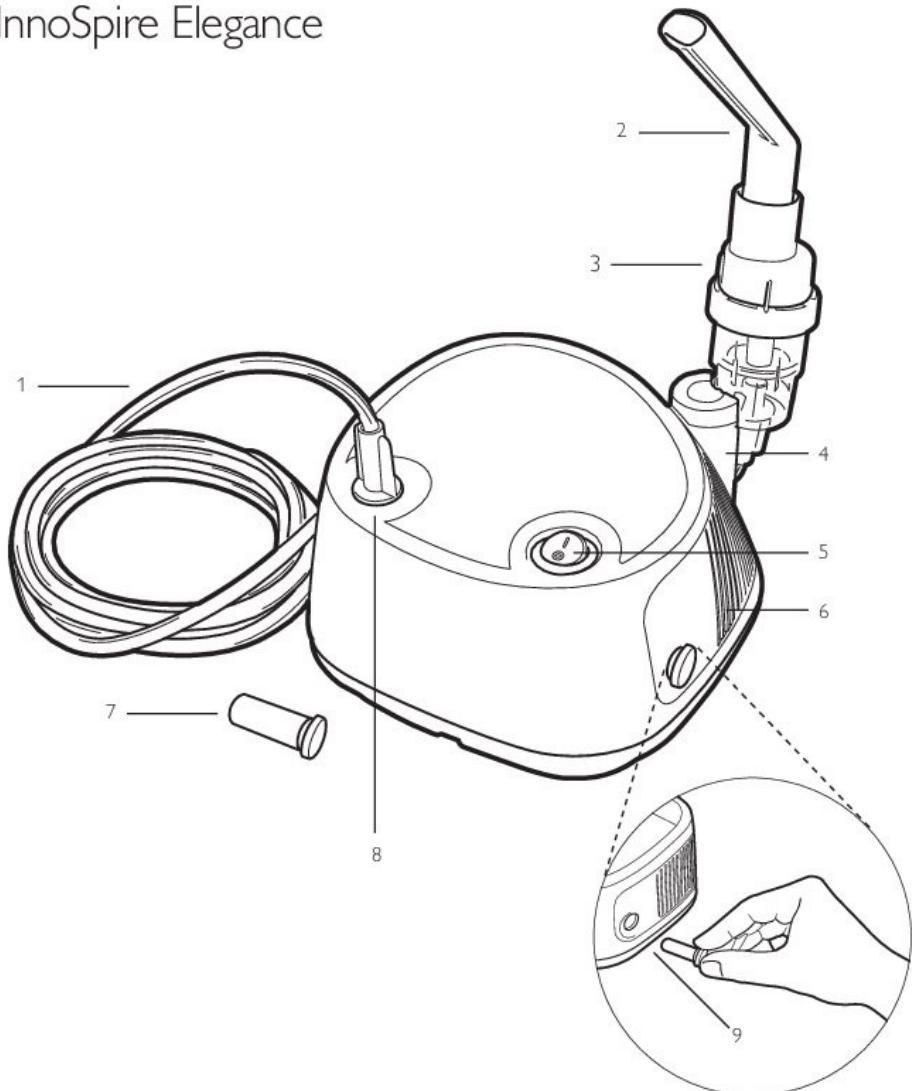

## Index

English	4
Български	9
Česky	15
Deutsch	21
Español	27
Eesti	33
Français	38
Ελληνικά	44
Indonesia Bahasa	50
Italiano	56
Latviski	62
Lietuviškai	68
Magyar	74
Nederlands	80
Norsk	86
Polski	92
Português	98
Русский	104
Română	110
Srpski	116
Slovenčina	122
Slovenščina	128
Svenska	134
ភាសាខ្មែរ	140
Türkçe	146
العربية	152
中文	158
فارسی	163
日本語	169
한국어	175



## БЪЛГАРСКИ

### Амбиентни условия

Условия на съхранение

Температура MIN -25 °C – MAX 70 °C (-13 °F – 158 °F)

Влажност MIN 10% RH – MAX 95% RH

### Работни условия

Температура MIN 5 °C – MAX 40 °C (41 °F – 104 °F)

Влажност MIN 10% RH – MAX 95% RH

Работно атмосферно налягане Функционирането може да се променя в зависимост от надморската височина, барометричното налягане и температура

Речник на символите

ON (включено електrozахранване)	ВНИМАНИЕ	Клас II, двойно изолиран
OFF (изключено електrozахранване)	Променили ток	Тип В приложени части
Сериен номер	Представител за Европа	Да се използва само на закрито
Следвайте инструкциите за употреба	Производител	Температурно ограничение
Сепарирано събиране		

### Гаранция

Respironics New Jersey, Inc. гарантира, че компресорът няма дефекти по отношение на материали и производство при нормална употреба и за период от 3 години от датата на закупуване от Respironics New Jersey, Inc. Гаранцията е ограничена до попавка или смяна, при единствена възможност в Respironics New Jersey, Inc., или други компоненти или оборудване обявени за дефекти, когато твърдението за дефект е приемливо по преноска на Respironics New Jersey, Inc. Тази гаранция не покрива никакви компоненти или оборудване, изложени на неправилна употреба, неправилна работа, инцидентна повреда или неоторизирани поправки, и не обхваща разходи за труд при поправката. Всички върнати апарати трябва да бъдат правилно опаковани и изпратени с предварително заплащане, от дистрибутора на продукта, който обслужва апаратът. Respironics New Jersey, Inc. не носят отговорност към купувача или други за загуба на оборудването или за непреки, или инцидентни или произтичащи повреди, които биха могли да възникнат.

1. Hadička nebulizátoru
2. Náustek nebulizátoru
3. Ruční nebulizátor
4. Držák nebulizátoru
5. Vypínač napájení

6. Průduch kompresoru
7. Vzduchový filtr
8. Vzduchový výstup kompresoru
9. Vstup vzduchu pro filtr

### Pokyny k použití

#### InnoSpire Elegance

**Důležité:** Před použitím tohoto zařízení si pečlivě pročtěte tyto pokyny. Pokud budete mít k výrobku jakékoli dotazy nebo pokud narazíte na problém, obrátte se na poskytovatele zdravotní péče nebo na oddělení zákaznických služeb společnosti Philips Resironics na čísle +00 1 724 387 4000.

### Obecné informace

**Stanovený způsob použití:** Tento výrobek je určen k tomu, aby sloužil jako zdroj stlačeného vzduchu pro lékařské účely. Používá se spolu s pneumatickým (tryskovým) nebulizátorem k vytváření aerosolových částic léčiva určeného k léčbě onemocnění dýchacích cest u dětí i dospělých.

### VAROVÁNÍ

- 1 Zařízení používejte k určenému účelu, který je popsán v této příručce k použití, jako kompresorový nebulizační systém pro aerosolovou terapii. Dodržujte pokyny lékaře. Jakékoli jiné použití znamená nesprávné použití a může být nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nerozumným používáním nebo pokud je jednotka připojena k elektrické sítí, která nesplňuje bezpečnostní nařízení.
- Doporučuje se mít připraveno záložní zařízení (např. inhalátor s odměřenou dávkou nebo kompresor napájený bateriemi), které by zajistilo dodávku vzduchu potřebného k dýchání v případě, že nastane situace, kdy nebulizátor nebude možno používat (např. při výpadku napájení ze sítě nebo jakkoli způsobené nefunkčnosti kompresoru).
- Pokud se zařízení ocítlo v místě, kde nebyly dodány předepsané provozní podmínky, zajistěte před jeho použitím obnovení normálních provozních technických parametrů.
- Dojde-li k vylití jakékoli kapaliny na nebo dovnitř zařízení, je zařízení před uvedením do provozu třeba nechat vyschnout.

2 Tuto příručku uchovejte pro budoucí použití.

3 Výrobek používejte v čistém prostředí, které je zbaveno špíny, prachu, srsti domácích zvířat atd.

## ČESKY



ČESKY

- 4 Zařízení by nemělo být používáno v blízkosti hořlavých látek ani v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem, kyslíkem nebo rajským plynem.
- 5 Žádné změny tohoto zařízení nejsou dovoleny.
- 6 Zahřívání zařízení, které je během používání na dotek patrné, je normální.
- 7 Kompresor neskladujte s jiným zařízením.
- 8 **Informace týkající se elektromagnetického rušení:** Přenosná a radiofrekvenční komunikační zařízení, jako například mobilní telefony, pagery atd., mohou rušit provoz elektrického zdravotnického vybavení. Z tohoto důvodu musí být kompresor umístěn v dostatečné vzdálenosti od těchto zařízení představujících zdroje rušení. Toto zařízení splňuje požadavky normy IEC60601-1-2 týkající se elektromagneticke kompatibility (EMC). O listy s údaji o elektromagneticke kompatibilitě můžete požádat oddělení zákaznických služeb společnosti Philips Respironics na čísle +00 1 724 387 4000.
- 9 V případě nefunkčnosti nebo poruchy si pročtěte část „Řešení potíží“. Kryt kompresoru neotevírejte, jelikož se nejedná o výrobek, který si můžete samostatně opravit.
- 10 Správné fungování zařízení může být narušeno, pokud nejsou použity originální náhradní díly(např. filtry).
- 11 Nebezpečí zasažení elektrickým proudem – neodnímejte zadní kryt.
- 12
- 13 Zařízení nepoužívejte bez filtru.
- 14 Při použití jakéhokoli elektrického přístroje je nutné vždy zachovávat určitá důležitá bezpečnostní opatření, včetně následujících:
  - Používejte pouze výrobcem dodávané originální příslušenství a součásti.
  - Nikdy jednotku neponořujte do vody, protože zařízení není chráněno proti pronikání vody.
  - Nikdy se jednotky nedotýkejte mokrýma ani vlhkýma rukama.
  - Nenechávejte jednotku venku.
  - Při používání zařízení položte na stabilní vodorovný povrch.
  - Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou blokovány.
  - Děti nebo nezpůsobilé osoby nesmí jednotku používat bez dozoru.
  - Jednotku nevypínejte vytážením zástrčky z elektrické zásuvky.
  - Zařízení nepoužívejte v okruhu s ventilátorem.
  - Zařízení nepoužívejte, vykazuje-li známky popraskání nebo jiného poškození.
- 15 Než zařízení zapojíte, ujistěte se, že elektrický výkon uvedený na štítku na spodní straně jednotky odpovídá napětí a frekvenci sítě.
- 16 Nepoužívejte žádné adaptéry, jednoduché ani násobné, ani prodlužovací kably.

- 17 Nenechávejte jednotku zapojenou, pokud ji nepoužíváte. Pokud zařízení není v provozu, odpojte je z elektrické zásuvky.
- 18 Postupujte podle pokynů výrobce k instalaci zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou instalací.
- 19 Napájecí kabel nesmí měnit uživatel. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, obrat' se na oddělení zákaznických služeb společnosti Philips Respironics (není k dispozici žádná volba servisu).
- 20 Před prováděním jakéhokoli čištění nebo výměny filtru odpojte zařízení od sítě.
- 21 Některé součásti jsou tak malé, že by je mohly děti spolknout. Zabraňte dětem v přístupu k jednotce bez dozoru.
- 22 Pokud zařízení již nepoužíváte, zlikvidujte je v souladu s místními platnými nařízeními.
- 23 Pamatujte si:
  - Toto zařízení používejte pouze s léky, které vám předepíše lékař.
  - Používejte příslušenství doporučené vaším lékařem.

## Pokyny k použití

### **Před použitím vyjměte kompresor z pouzdra, byl-li v pouzdře dodán.**

- 1 Po vybalení zařízení zkontrolujte kompresor a příslušenství, zda nenajdete viditelná poškození nebo vadu, jako například praskliny plastového krytu, které by mohly odhalit elektrické součásti. Chcete-li nahlásit poškozený výrobek, obraťte se na oddělení zákaznické podpory společnosti Philips Respironics nebo na vašeho distributora výrobků.
- 2 Při léčbě seděte vzpřímeně a pohodlně.
- 3 Připojte kompresor do elektrické zásuvky.
- 4 Před zahájením léčby si přečtěte pokyny k použití nebulizátoru a příslušenství.
- 5 Léčbu zahájte zapnutím zařízení tak, že vypínač přepnete do polohy „I“.
- 6 Po dokončení léčby jednotku vypněte přepnutím vypínače do polohy „O“ a odpojením zástrčky z elektrické zásuvky.



ČESKY

## Čištění a údržba

**⚠ Během čištění zkонтrolujte, zda není napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky.**

### Čištění kompresoru, nebulizátoru a příslušenství

Nebulizátor a příslušenství čistěte podle dodaných pokynů.

Pomocí čistého vlhkého hadřku očistěte vnější části jednotky.

### Výměna nebulizátoru

Nebulizátor a další příslušenství je třeba měnit podle dodaných pokynů.

### Výměna filtru

Filtr je nutno vyměnit, je-li zabarvený nebo mokrý.

### Řešení potíží

Zařízení se nezapne

- Zkontrolujte, zda je zástrčka pevně zapojena do elektrické zásuvky.

V případě poruchy (nedostatečný tlak a průtok) vypněte jednotku na 10 sekund a poté ji znova zapněte.

Po každém čištění zkonzrolujte, zda jednotka pracuje správně. Ověřte, zda z trysky vychází vzduch, když je jednotka v pozici ZAPNUTO.

Neoprávněné opravy vedou k ukončení záruky.

**Pokud zařízení ani po provedení těchto kroků nepracuje správně, obrátěte se na autorizovaného distributora výrobků nebo na oddělení zákaznických služeb společnosti Philips Respironics na čísle +00 1 724 387 4000.**

### Údržba a opravy

**Zařízení nikdy neotvírejte.** Jednotka neobsahuje žádné součásti, které si můžete opravit sami.

Kompresor nevyžaduje mazání ani jinou údržbu.

### Technické údaje

Zdroj elektřiny	230 V/50 Hz, 1 A
Ochrana před přehřátím	Tepelná pojistka; provozní teplota 150 °C
Maximální tlak kompresoru	317 kPa (46 psi)
Průměrný průtok	6 l/min při 10 psig
Maximální průtok	8,0 l/min
Hmotnost	1,5 kg
Velikost	165 x 165 x 108 mm
Hlučnost	58 ± 3 dBA

### Technické údaje

Zdroj elektřiny	220 V/60 Hz, 1,2 A
Ochrana před přehřátím	Tepelná pojistka; provozní teplota 150 °C
Maximální tlak kompresoru	296 kPa (43 psi)
Průměrný průtok	7 l/min při 10 psig
Maximální průtok	9,3 l/min
Hmotnost	1,5 kg
Velikost	165 x 165 x 108 mm
Hlučnost	58 ± 3 dBA

Zařízení třídy II, typu B (zařízení se speciální ochranou před úrazy elektrickým proudem)

### DVOJITÁ IZOLACE

### Referenční standardy

Standarty elektrické bezpečnosti IEC 60601-1
Elektromagnetická kompatibilita dle normy IEC-60601-1-2

### Okolní prostředí

Skladovací podmínky	
Teplota	Min. -25 °C – max. 70 °C
Vlhkost	Min. 10 % relativní vlhkosti – max. 95 % relativní vlhkosti
Provozní podmínky	
Teplota	Min. 5 °C – max. 40 °C
Vlhkost	Min. 10 % relativní vlhkosti – max. 95 % relativní vlhkosti
Provozní atmosférický tlak	Výkon se může lišit v závislosti na nadmořské výšce, barometrickém tlaku a teplotě



ČESKY

## Vysvětlení symbolů

■ ZAPNUTO (napájení)

○ VYPNUTO (napájení)

SN Výrobní číslo

Postupujte podle pokynů k použití

☒ Oddělený odpad

⚠ POZOR

~ Střídavý proud

■ Evropské zastoupení

■ Výrobce

□ Třída II, dvojitá izolace

■ Přiložné části typu B

■ Pouze vnitřní použití

■ Teplotní limit

## Záruka

Společnost Resironics New Jersey, Inc. se zaručuje, že kompresor nemá žádné vady materiálu ani výrobní vady při normálním používání a provozu, a to po dobu 3 let od data zakoupení od společnosti Resironics New Jersey, Inc. Záruka je omezena na opravu nebo výměnu na základě výhradněho rozhodnutí společnosti Resironics New Jersey, Inc., pokud budou jakékoli součásti nebo zařízení shledány vadnými a pokud společnost Resironics New Jersey, Inc. shledá požadavek jako podaný v dobré věře. Tato záruka se nevtahuje na žádné součásti nebo zařízení, pokud došlo k jejich nevhodnému použití, nesprávnému provozu, náhodnému poškození nebo neautorizované opravě a nevtahuje se na poplatky za provedené opravy. Distributor výrobků, který servis dané jednotky provádí, musí všechny vrácené položky rádně zabalit, odeslat a předem zaplatit. Společnost Resironics New Jersey, Inc. nenese žádnou odpovědnost za kupujícího ani jiné osoby, pokud nelze zařízení používat, a nenese žádnou odpovědnost ani za nepřímečné, náhodné nebo následné školy, které mohou vzniknout.

DEUTSCH

1. Vernebler-Schlauch
2. Vernebler-Mundstück
3. Vernebler-Handgerät
4. Vernebler-Halterung
5. Ein-/Ausschalter
6. Kompressor-Lüftungsöffnungen
7. Luftfilter
8. Kompressor-Luftauslass
9. Lufteinlass für den Filter

## Gebrauchsanleitung

## InnoSpire Elegance

**Wichtig:** Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren medizinischen Betreuer oder telefonisch an den Kundendienst von Philips Resironics unter der Nummer +00 1 724 3874000.

## Allgemeine Informationen

**Verwendungszweck:** Dieses Produkt erzeugt Druckluft für medizinische Zwecke. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem pneumatischen (Düsen)-Vernebler vorgesehen, der Aerosolpartikel von Medikamenten für die Atemwegstherapie bei Kindern und Erwachsenen erzeugt.

## WARNHINWEISE

- 1 Das Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck als Kompressor-Vernebler-System zur Aerosoltherapie verwendet werden. Die Anweisungen des Arztes sind zu beachten. Jede andere Verwendung ist unsachgemäß und kann gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen oder wenn das Gerät an eine Elektroinstallation angeschlossen wird, die nicht den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
  - Es empfiehlt sich, ein Ersatzgerät für die Aerosoltherapie bereitzuhalten (z. B. ein treibgasgetriebenes Dosieraerosol [MDI] oder einen Kompressor mit Batteriestromversorgung), falls der Vernebler nicht genutzt werden kann (z. B. bei Stromausfall oder bei sonstigen Funktionsstörungen des Kompressors).
  - Falls einer der für den Betrieb des Geräts geltenden Grenzwerte überschritten wurde, darf das Gerät erst dann wieder verwendet werden, wenn zulässige Betriebsbedingungen herrschen.
  - Ist Flüssigkeit auf oder in das Gerät gelangt, muss es vor dem Gebrauch trocknen.
- 2 Diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- 3 Das Produkt darf nur in einer sauberer Umgebung verwendet werden, die frei von Schmutz, Staub, Tierhaaren usw. ist.